



4304.101.00840




4304.100.5994...



T1
4304.021.2449...
ou/of DY 71514



CH5 : 4304.092.02690



4304.100.5995...



CH1 : 4304.092.02800




S1
4304.022.55980



CH6
4304.092.03940



CH4
4304.094.01430



CH3
4304.093.91260



CH2
4304.094.01440




4304.022.36020
S2



4304.092.81610
PT2



DY 86002



C29



DY 62031
S3



4304.092.80650
PT1



DZ 15744



C25



DY 62030
S3



4304.010.65000
BR1



DY 86001



4304.010.70090



4304.983.41910
RD1




56.200



DY 85996/...




E 098 CG...
R19, R21, R29

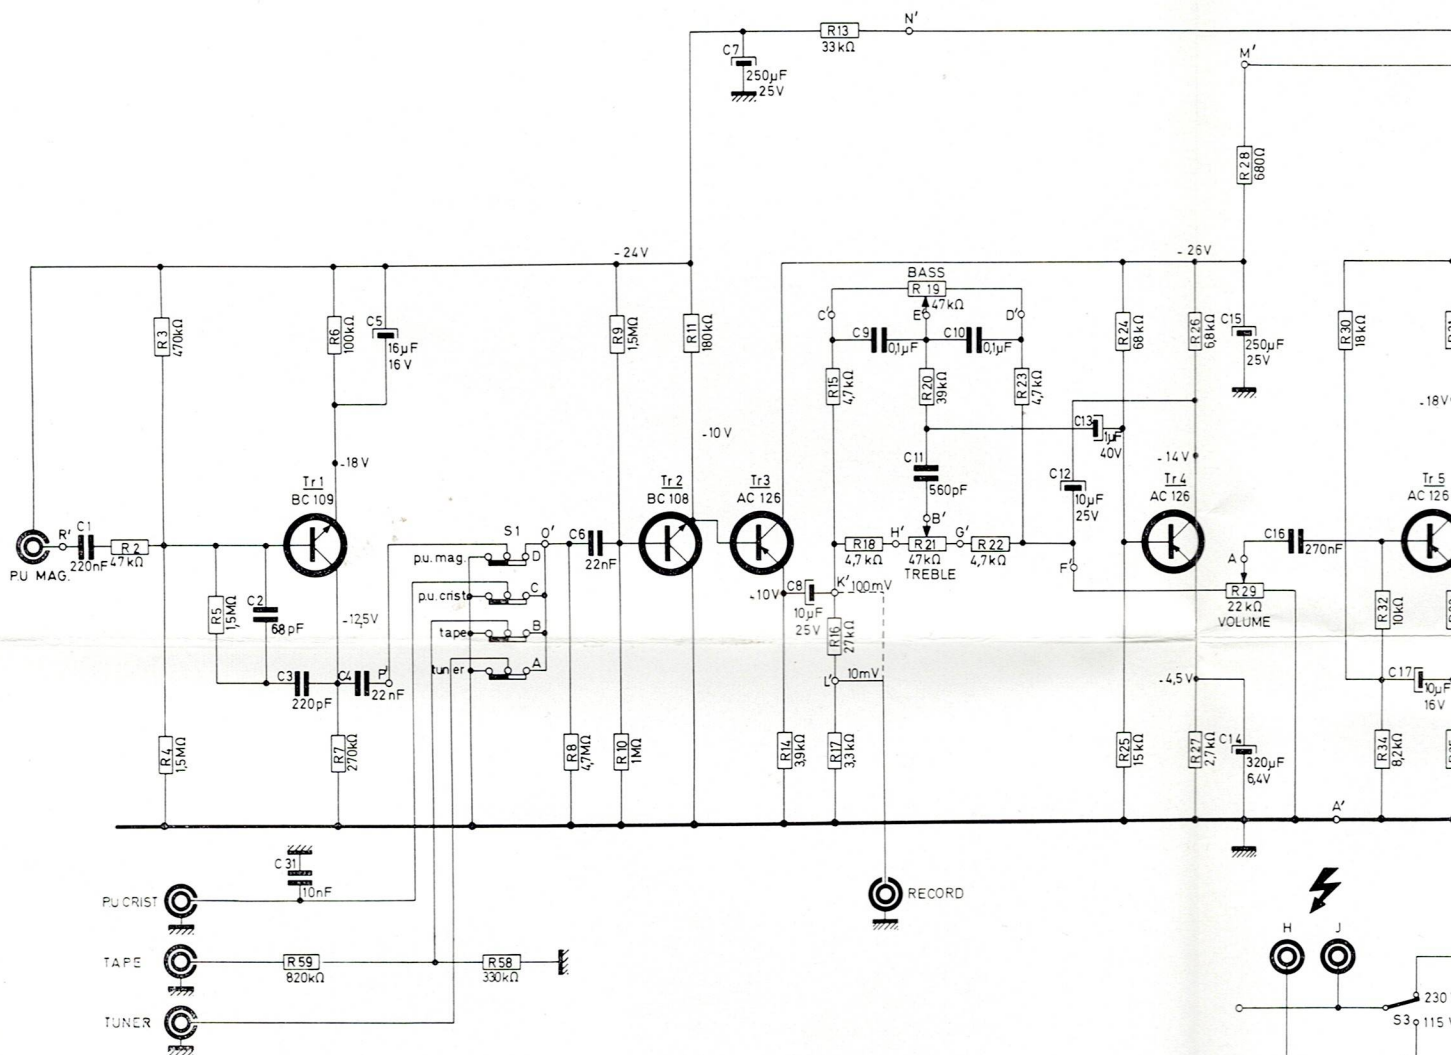


Toutes les tensions sont continues, sauf celles marquées ~ (alternatives).
Toutes les mesures se font par rapport à la masse (tolérance 20 %).
Appareil de mesure : 20 000 Ω/V, en continu ; 2 000 Ω/V, en alternatif.
Les cosses marquées 'se trouvent sur le circuit imprimé PRÉAMPLIFICATEUR.
Alle spanningen zijn gelijkspanningen, behalve deze aangeduid met ~ (wisselspanningen).
Alle metingen worden gedaan ten opzichte van de massa (tolerantie 20 %).
Meetinstrument : 20 000 Ω/V, voor gelijkspanning ; 2 000 Ω/V, voor wisselspanning.
De tipjes gemerkt met ' bevinden zich op de VOORVERSTERKER printplaat.




VUES CÔTÉ ÉLÉMENTS
AANZICHTEN ELEMENTEN ZIJDE

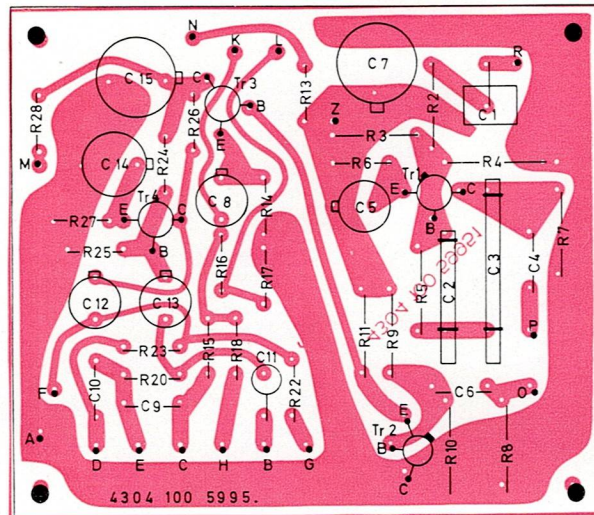


PRÉAMPLIFICATEUR
VOORVERSTERKER

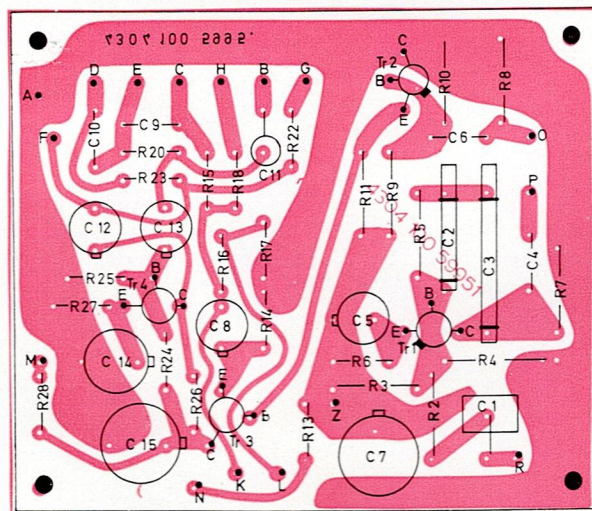

VUES CÔTÉ CUIVRÉ
AANZICHTEN VERKOPERDE ZIJDE

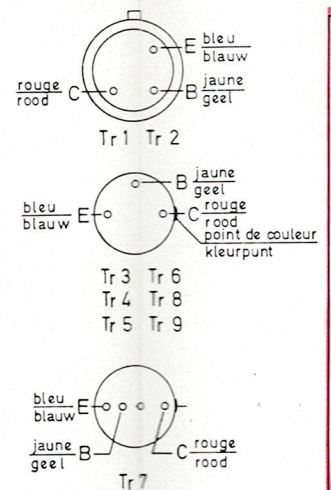

VUES CÔTÉ ÉLÉMENTS
AANZICHTEN ELEMENTEN ZIJDE

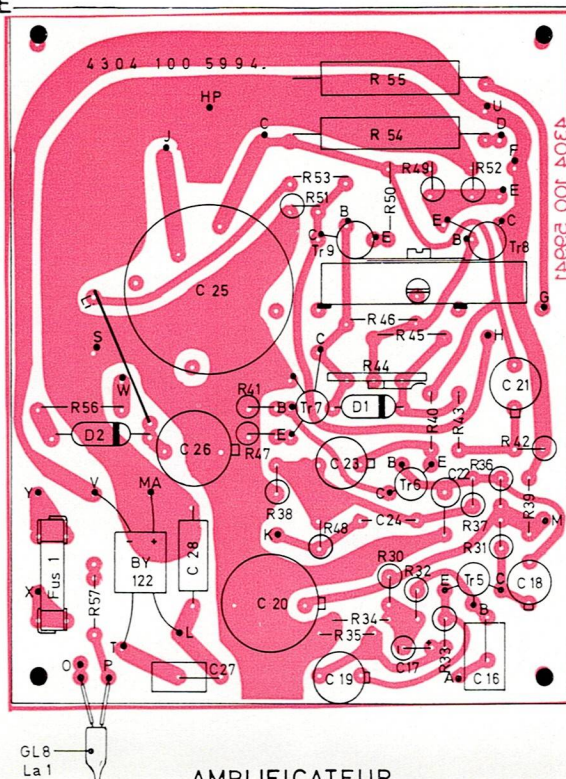

AMPLIFICATEUR
VERSTERKER

VUES CÔTÉ CUIVRÉ
AANZICHTEN VERKOPERDE ZIJDE

